


MDR: waar moet ik aan voldoen?

De Medical Devices Regulation uitgelegd

BG.legal

advocaten

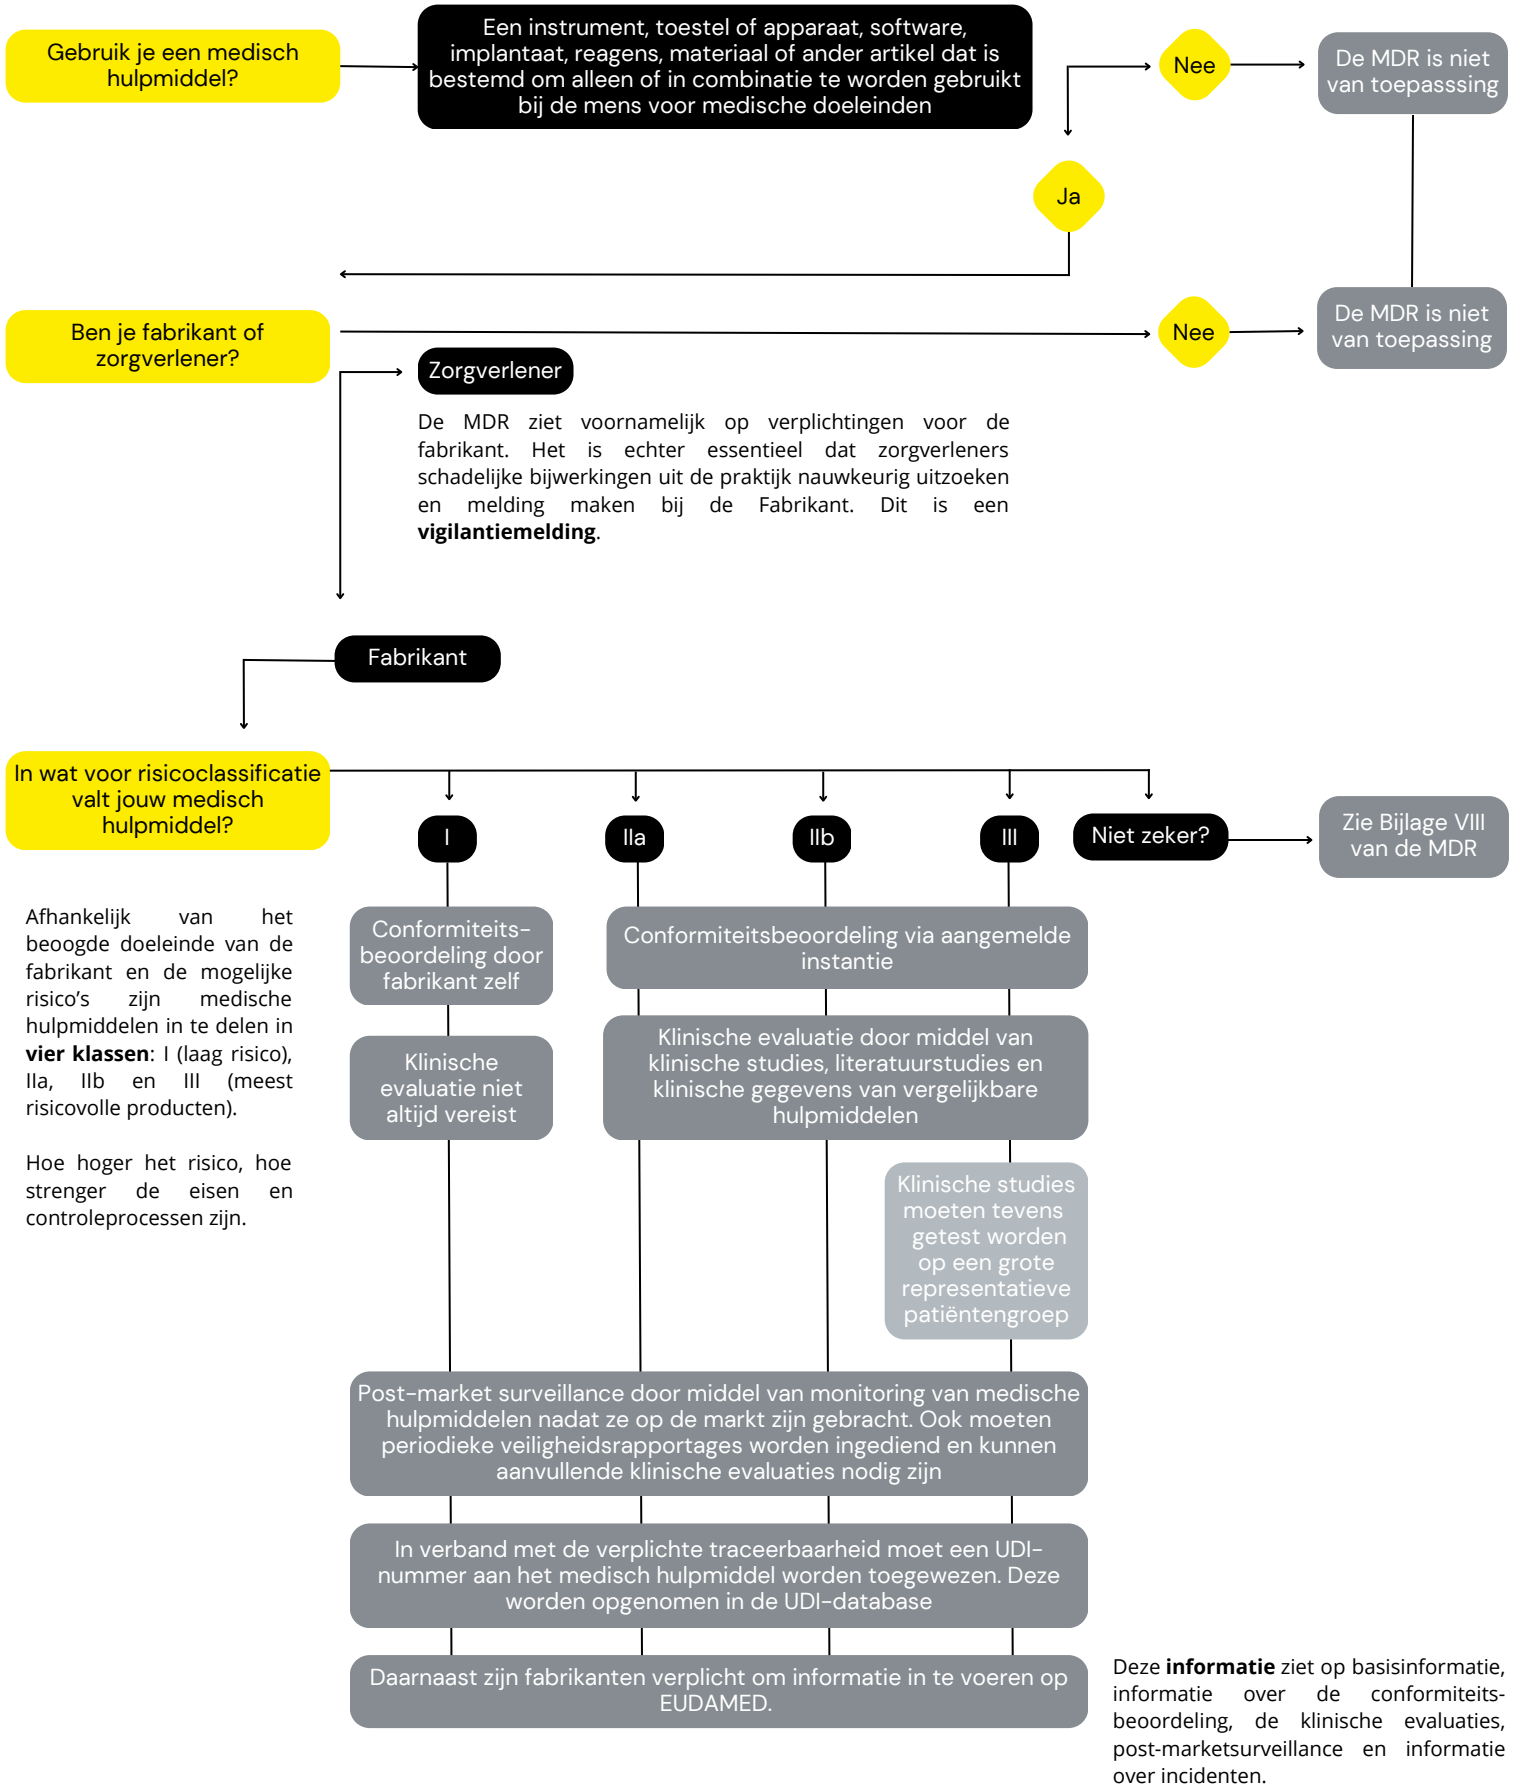

Indien het oude certificaat is verlopen is de verlenging niet van toepassing. Voor deze medische hulpmiddelen geldt de **overgangsperiode tot 26 mei 2024**.

Heeft u nog vragen over de MDR? Neem gerust contact op met een van onze medewerkers.